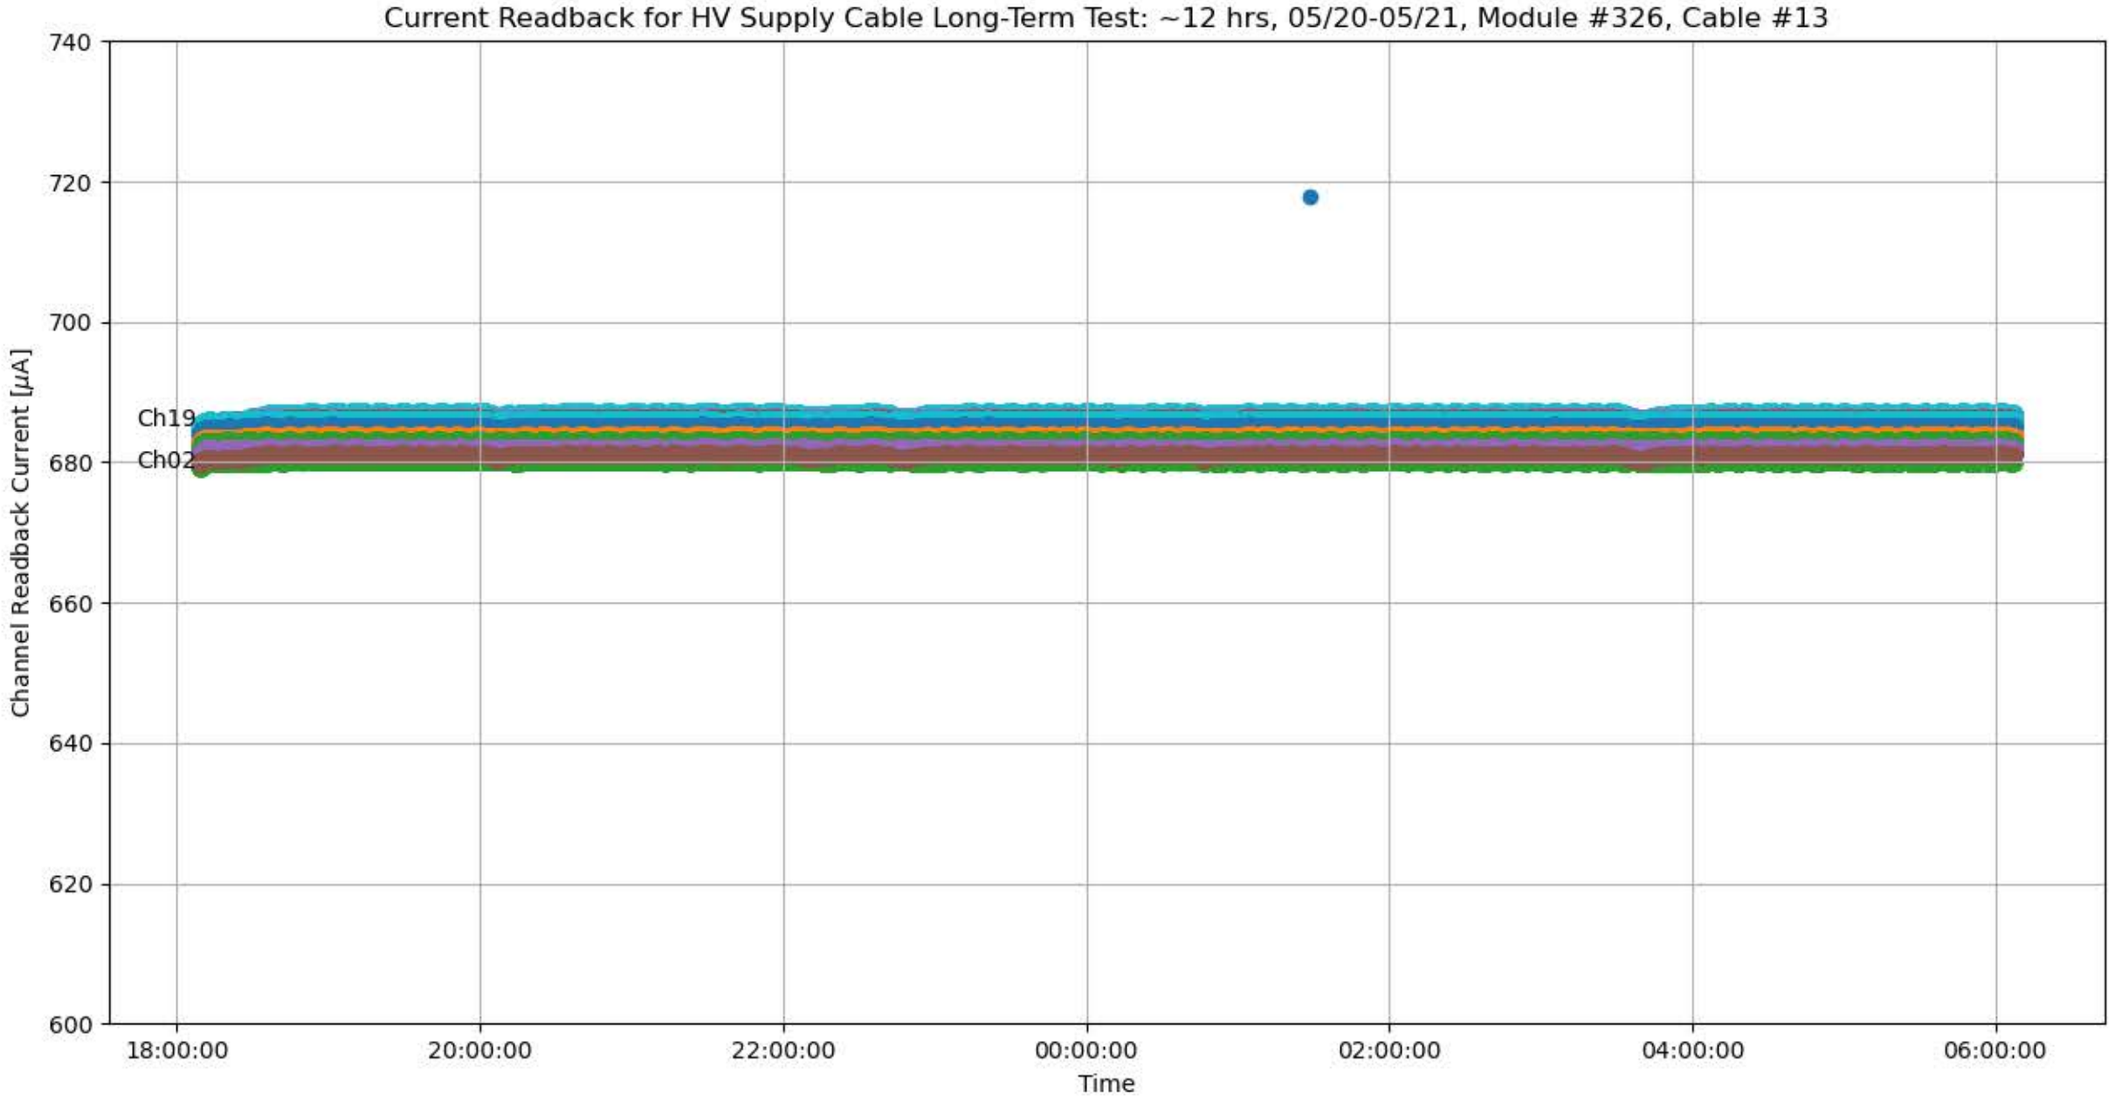
Current Readback for HV Supply Cable Long-Term Test: ~12 hrs, 05/20-05/21, Module #326, Cable #13
Channel Readback Current [μA]
740
720
700
680
660
640
620
600
Ch19
Ch02
18:00:00
20:00:00
22:00:00
00:00:00
02:00:00
04:00:00
06:00:00
Time